



Prefeitura Do Município De Salinho

Relatório Fotográfico

Amstras do Pregão Presencial N° 38/2022

Cirúrgica União LTDA

CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS MÉDICOS, CIRÚRGICOS,
HOSPITAIS, ÁREAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL
E-mail: uniao@cirurgicauniao.com.br

Rua 25, 1908/1928 - Jd. São Paulo - CEP 13565-810
Tel / Fax: (19) 3526-1908 - RIO CLARO - SP
CNPJ: 04.063.331/0001-21
INSC. EST.: 587.122.394.114

Rio Claro, 15 De Março De 2023

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
A/C DEPTO. COMPRAS / LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2022


ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA
89	UNID	Dispositivo intravenoso periférico de segurança 24G x 0,7mm, do tipo por fora da agulha de uso único, estéril, descartável, construído por Agulha siliconada com bisele triangular e trifacetado. Cateter em biomaterial polietileno (vidal) flexível transparente (radiopaco). Protetor de agulha/cateter. Conector Luer Lok, translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal permitindo rápida visualização do refluxo sanguíneo e tampa filtro da câmara de refluxo do tipo bico - seletivo reduzindo a pressão interna da câmara, permitindo a visualização do sangue no exato momento da punção. Dispositivo de segurança acionado pelo usuário, com proteção instantânea e total da agulha, proteção total de todo comprimento da agulha, evitando o contato com sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde. Possui orifício localizado à 2mm do calcanhar, do bisele da agulha (Insufflati™ Needle Technology) que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico. Esterilizado por óxido de etileno, proporcionando abertura asséptica de transferência. Contém dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, número de lote, data de esterilização, validade do produto e registro no Ministério da saúde, conforme portaria MS-SVS, de 23/01/96. Origem Brasil.	NUSAF
140	UNID	Kit de máscara de oxigênio alta concentração com reservatório. Máscara em PVC (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico. Não esterilizável.	ADVANTIVE

CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS MÉDICOS, CIRÚRGICOS,
HOSPITAIS, ÁREAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL
E-mail: uniao@cirurgicauniao.com.br


Rua 25, 1908/1928 - Jd. São Paulo - CEP 13565-810
Tel / Fax: (19) 3526-1908 - RIO CLARO - SP
CNPJ: 04.063.331/0001-21
INSC. EST.: 587.122.394.114

173	UNID	Reanimador manual pediátrico, autoclavável e resistente a desinfecção química e de alto nível, confeccionado em puro silicone; com reservatório de O ₂ confeccionado em 100% silicone, sem costuras de capacidade mínima de 2000 ml, em PVC; máscara facial pediátrica transparente em silicone autoclavável, válvula de segurança e unidirecional em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas; reservatório de O ₂ com válvula e membranas autoclaváveis, válvula de admissão de ar/O ₂ , autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueável para conexão do reservatório à rede de O ₂ ; e com acessórios inclusos: 03 máscaras faciais nºs 01,02 e 03.	SAFTI
-----	------	---	-------

F 01 – Relação de amostras.

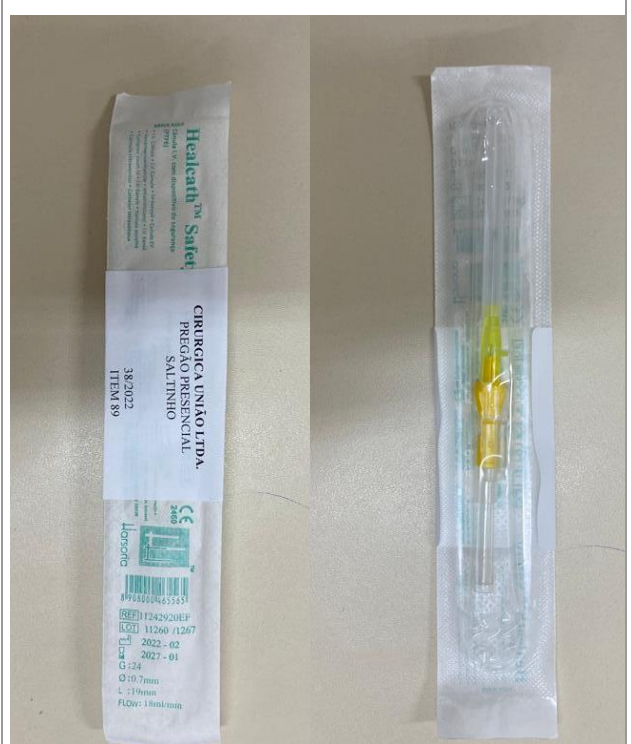

F 02 – Amostra item 89.

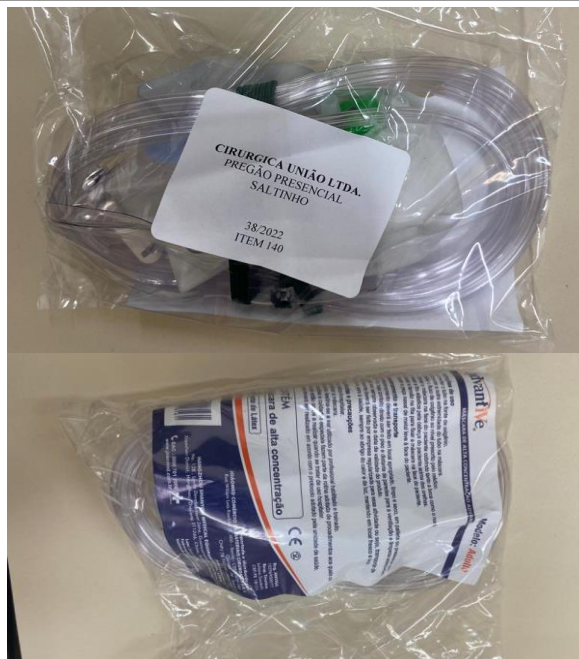



F 03 – Amostra item 140.



F 04 – Amostra item 173.



Prefeitura Do Município De Salinho
Relatório Fotográfico
Amostras do Pregão Presencial N° 38/2022
Comercial Concorrent Eireli Epp

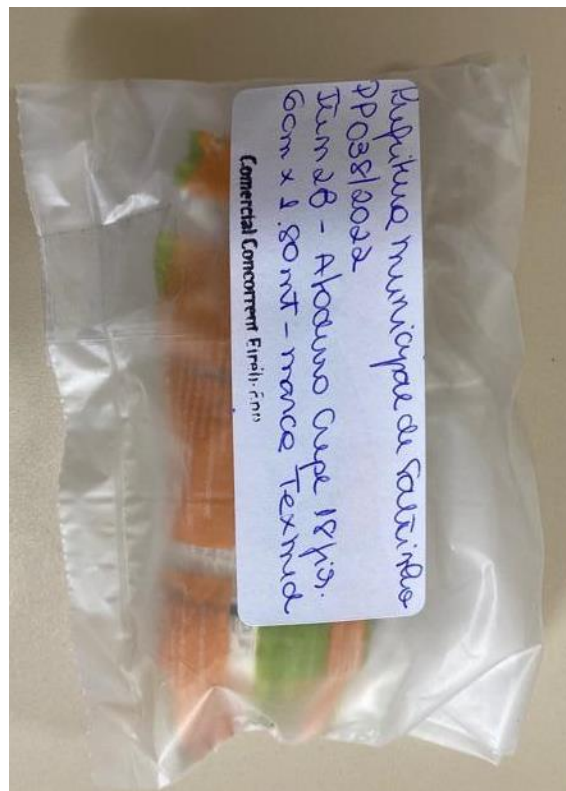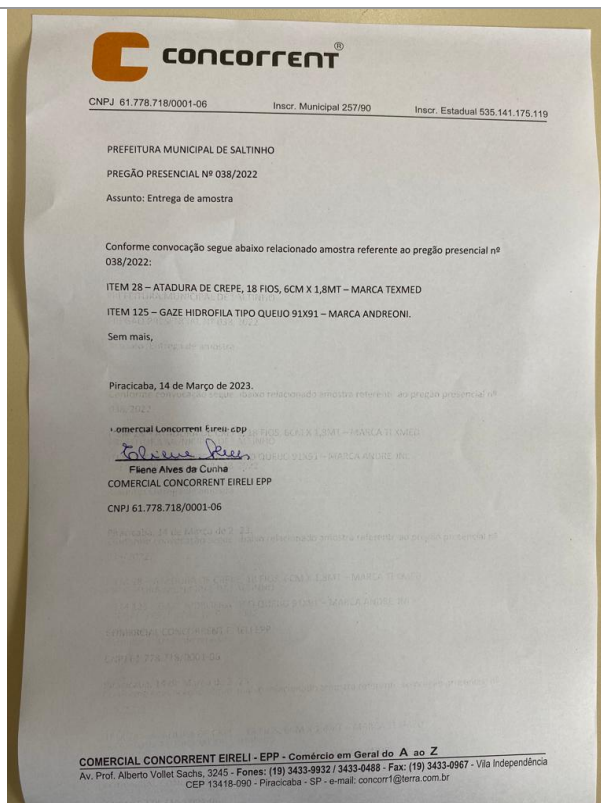


F 01 – Relação das amostras.

F 02 – Amostra item 28.



F 03 – Amostra item 125.

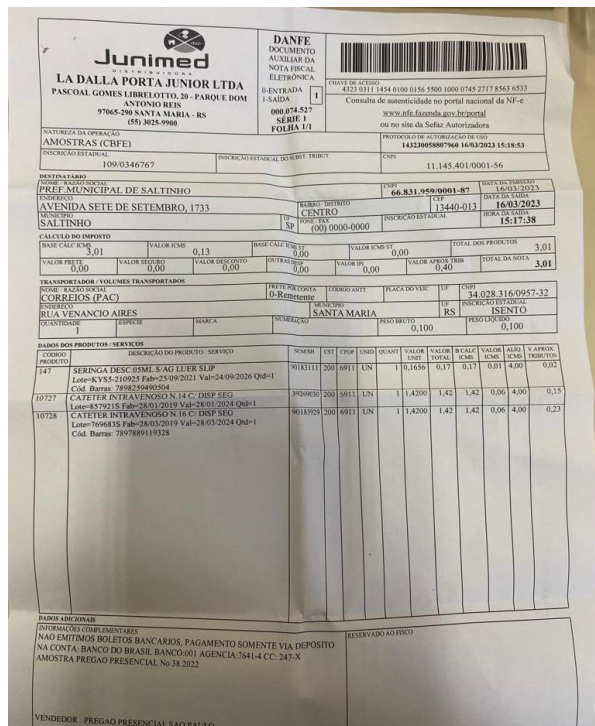

F 02 – Nota de remessa das amostras.



F 04 – Amostra item 83 e 84 respectivamente.



F 01 – DANFE das amostras

F 02 – Caixa com as amostras.



F 03 – Amostra item 105.

F 04 – Amostra item 137.



Prefeitura Do Município De Saltinho
Relatório Fotográfico
Amostras do Pregão Presencial N° 38/2022 -
Med Center Comercial LTDA




F 01 – Caixa com amostras.



F 02 – Caixa com amostras.



F 03 – Amostra item 45.

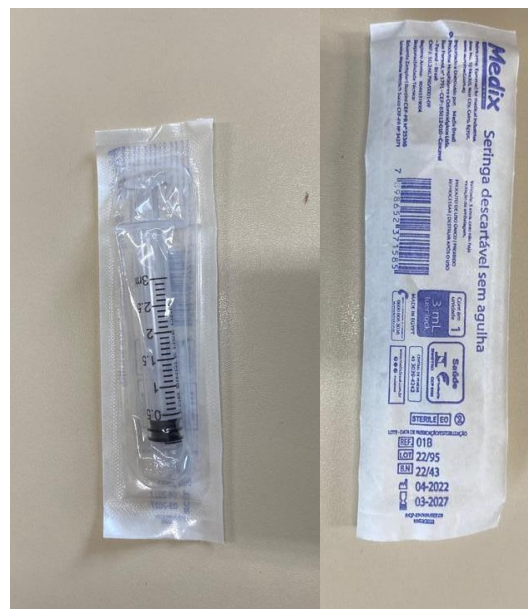

F 04 – Amostra item 177.



F 05 – Caixa com amostra.

F 06 – Nota de remessa da amostra.





Prefeitura Do Município De Salinho
Relatório Fotográfico
Amostras do Pregão Presencial N° 38/2022
Medefe Produtos Médicos Hospitalares



F 01 – Envelope da entrega das amostras.



F 02 – Amostra item 81.



F 03 – Amostra item 194.



Prefeitura Do Município De Salinho
Relatório Fotográfico
Amostras do Pregão Presencial N° 38/2022
Primemed Comércio e Distribuidora LTDA



F 01 – Envelope (frente) com a amostra.



F 02 – Envelope (verso) com a amostra.



F 03 – Amostra item 93.



F 04 – Amostra item 93.



Prefeitura Do Município De Saltinho

Relatório Fotográfico

Amostras do Pregão Presencial N° 38/2022


Rosicler Cirurgica LTDA- EPP



F 01 – Caixa com amostra.



F 02 – Relação de amostras.

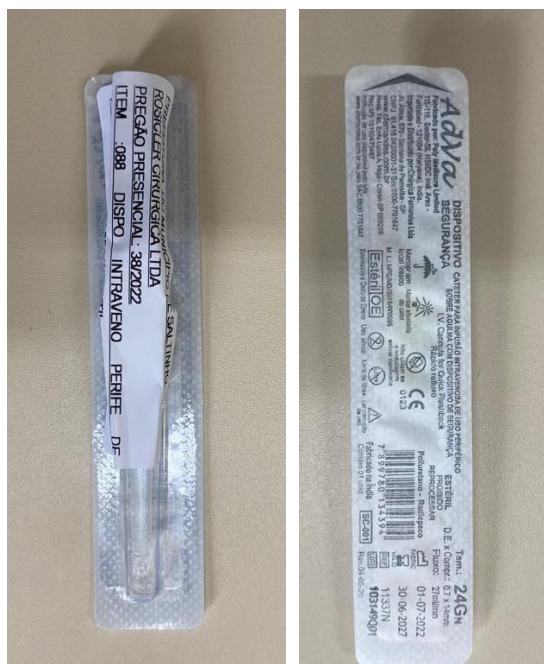


F 03 – Amostra item 88.




F 04 – Amostra item 141.



Prefeitura Do Município De Salinho
Relatório Fotográfico
Amostras do Pregão Presencial N° 38/2022
Rosicler Cirurgica LTDA- EPP

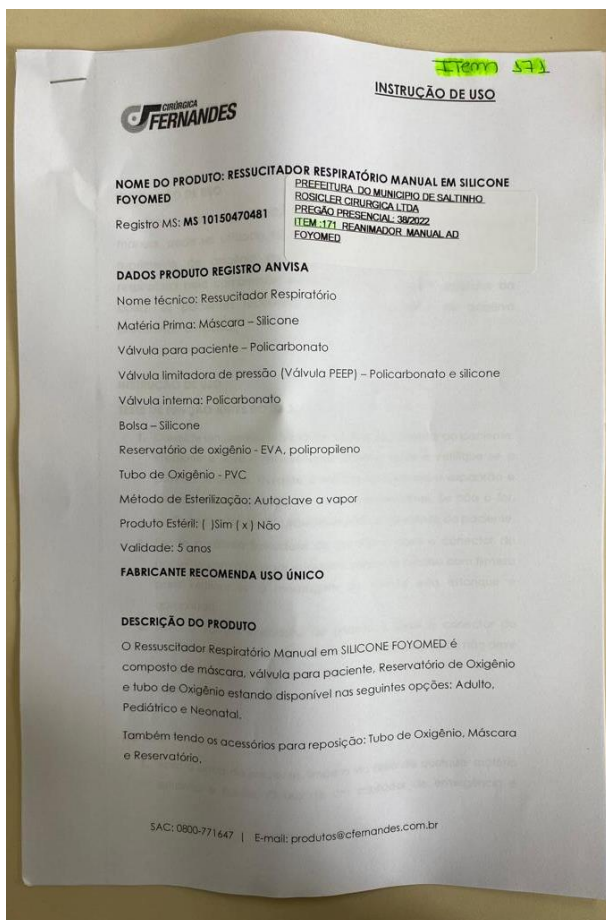

F 05 – Item 171 empresa apresentou somente o manual.

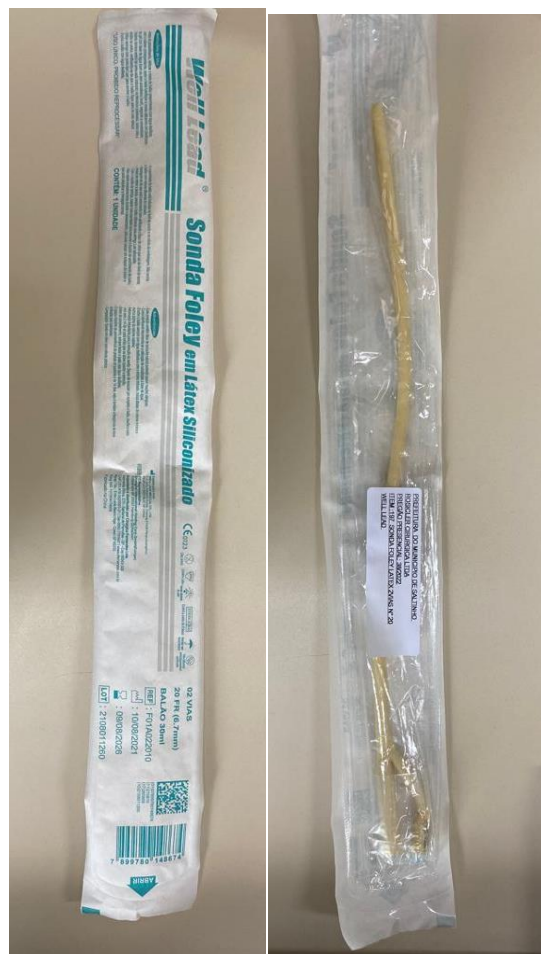

F 06 – Amostra item 197.